


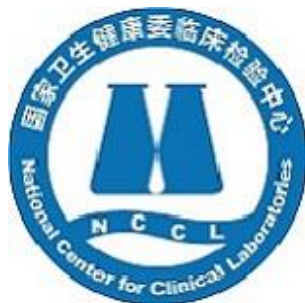

2024年

全国临床检验室间质量评价报告

单位（实验室）编码： 104043-3
单位（实验室）名称： 保定市第二医院（南院）
计划名称： 肿瘤标志物A

计划编码： NCCL-C-08
质评轮次： 第1次

负责科室： 临床生化室
联系电话： 010-58115059

通信地址： 北京东单大华路一号 国家卫生健康委临床检验中心 室间质评室
邮 编： 100730
联系电话： 010-58115055, 65273025, 58115065
传 真： 010-65273025
电子邮箱： EQA@nccl.org.cn

国家卫生健康委临床检验中心



国家卫生健康委临床检验中心

2024年全国肿瘤标志物A室间质量评价 统计结果

实验室名称：保定市第二医院（南院）	测定日期：2024/5/29	第1次	科室：检验二科
实验室编码：104043-3			统计日期：2024/6/19

项目：CEA		ng/mL						
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	评价结果
202411	64.0	63.6	0.63	47.7 - 79.5		*		通过
202412	5.1	5.1	0.00	3.8 - 6.4		*		通过
202413	26.8	27.8	-3.60	20.9 - 34.8		*		通过
202414	65.0	63.6	2.20	47.7 - 79.5		*		通过
202415	108.0	101.4	6.51	76.1 - 126.8		*		通过

所属组	深圳新产业（化学发光）组	成绩	100%
本组实验室数	542		
方法	鲁米诺/异鲁米诺化学发光		
仪器	深圳新产业 Maglumi 全自动化学发光测定仪系列		
试剂	深圳新产业（化学发光）		
校准物	深圳新产业（化学发光）		

项目：AFP		ng/mL						
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	评价结果
202411	120.0	128.5	-6.61	96.4 - 160.6		*		通过
202412	27.0	24.6	9.76	18.5 - 30.8			*	通过
202413	69.0	67.1	2.83	50.3 - 83.9			*	通过
202414	165.0	176.5	-6.52	132.4 - 220.6		*		通过
202415	220.0	217.6	1.10	163.2 - 272.0		*		通过

所属组	深圳新产业（化学发光）组	成绩	100%
本组实验室数	541		
方法	鲁米诺/异鲁米诺化学发光		
仪器	深圳新产业 Maglumi 全自动化学发光测定仪系列		
试剂	深圳新产业（化学发光）		
校准物	深圳新产业（化学发光）		



国家卫生健康委临床检验中心

2024年全国肿瘤标志物A室间质量评价 统计结果

实验室名称：保定市第二医院（南院）	科室：检验二科
实验室编码：104043-3	测定日期：2024/5/29 第1次 统计日期：2024/6/19

项目：CA199		U/mL						
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	评价结果
202411	226.0	220.0	2.73	165.0 - 275.0		*		通过
202412	24.2	24.5	-1.22	18.4 - 30.6		*		通过
202413	120.0	121.4	-1.15	91.1 - 151.8		*		通过
202414	319.0	298.3	6.94	223.7 - 372.9		*		通过
202415	420.0	436.5	-3.78	327.4 - 545.6		*		通过

所属组	深圳新产业（化学发光）组	成绩	100%
本组实验室数	533		
方法	鲁米诺/异鲁米诺化学发光		
仪器	深圳新产业 Maglumi 全自动化学发光测定仪系列		
试剂	深圳新产业（化学发光）		
校准物	深圳新产业（化学发光）		

项目：CA125		U/mL						
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	评价结果
202411	158.0	150.4	5.05	112.8 - 188.0		*		通过
202412	30.0	28.7	4.53	21.5 - 35.9		*		通过
202413	88.3	83.8	5.37	62.9 - 104.8		*		通过
202414	200.0	189.2	5.71	141.9 - 236.5		*		通过
202415	259.0	244.2	6.06	183.2 - 305.3		*		通过

所属组	深圳新产业（化学发光）组	成绩	100%
本组实验室数	528		
方法	鲁米诺/异鲁米诺化学发光		
仪器	深圳新产业 Maglumi 全自动化学发光测定仪系列		
试剂	深圳新产业（化学发光）		
校准物	深圳新产业（化学发光）		



国家卫生健康委临床检验中心

2024年全国肿瘤标志物A室间质量评价 统计结果

实验室名称：保定市第二医院（南院）	科室：检验二科
实验室编码：104043-3	测定日期：2024/5/29 第1次 统计日期：2024/6/19

项目：CA153		U/mL						
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	评价结果
202411	105.0	104.5	0.48	78.4 - 130.6		*		通过
202412	29.0	28.4	2.11	21.3 - 35.5		*		通过
202413	61.0	61.4	-0.65	46.1 - 76.8		*		通过
202414	140.0	139.9	0.07	104.9 - 174.9		*		通过
202415	193.0	194.0	-0.52	145.5 - 242.5		*		通过

所属组	深圳新产业（化学发光）组	成绩	100%
本组实验室数	522		
方法	鲁米诺/异鲁米诺化学发光		
仪器	深圳新产业 Maglumi 全自动化学发光测定仪系列		
试剂	深圳新产业（化学发光）		
校准物	深圳新产业（化学发光）		

项目：铁蛋白		ng/mL						
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	评价结果
202411	368.0	343.8	7.04	257.9 - 429.8		*		通过
202412	60.0	65.5	-8.40	49.1 - 81.9		*		通过
202413	185.0	194.0	-4.64	145.5 - 242.5		*		通过
202414	450.0	483.9	-7.01	362.9 - 604.9		*		通过
202415	716.0	673.0	6.39	504.8 - 841.3		*		通过

所属组	深圳新产业（化学发光）组	成绩	100%
本组实验室数	438		
方法	鲁米诺/异鲁米诺化学发光		
仪器	深圳新产业 Maglumi 全自动化学发光测定仪系列		
试剂	深圳新产业（化学发光）		
校准物	深圳新产业（化学发光）		



国家卫生健康委临床检验中心

2024年全国肿瘤标志物A室间质量评价 统计结果

实验室名称：保定市第二医院（南院）	测定日期：2024/5/29	第1次	科室：检验二科
实验室编码：104043-3			统计日期：2024/6/19

项目：总 β -HCG		IU/L						
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	评价结果
202411	312.0	314.2	-0.70	235.7 - 392.8		*		通过
202412	19.7	19.3	2.07	14.5 - 24.1		*		通过
202413	151.0	156.1	-3.27	117.1 - 195.1		*		通过
202414	353.0	368.1	-4.10	276.1 - 460.1		*		通过
202415	544.0	564.1	-3.56	423.1 - 705.1		*		通过

所属组	深圳新产业（化学发光）组	成绩	100%
本组实验室数	125		
方法	鲁米诺/异鲁米诺化学发光		
仪器	深圳新产业 Maglumi 全自动化学发光测定仪系列		
试剂	深圳新产业（化学发光）		
校准物	深圳新产业（化学发光）		

你室主任签字 _____
签字日期 _____