



河北秋珩检测科技有限公司
HEBEIQIUHENGJIANCKEKEJIYOUXIANGONGSI

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: QHJC20240823T001
Certificate No.

客户名称: 保定市第二医院
Client Name
联络信息: 东风西路338号
Contact Information
器具名称: 医用冷藏箱
Instrument Name
型号规格: HYC-310S
Mode/Type
出厂编号: BE0UD B0000 0QEP6 6PXLR
Serial No.
管理编号: /
Management No.
制造单位: 青岛海尔生物医疗股份有限公司
Manufacturer



批准人 刘雷
Approved by
核验员 刘雷
Checked by
校准员 苏彦彩
Calibrated by

接收日期	2024	年	08	月	23	日
Received Date		Year		Month		Day
校准日期	2024	年	08	月	23	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期	2024	年	08	月	23	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址: 保定市兴业路289号U谷产业园1号楼

Address: Building 1, U Gu Industrial Park, No. 289, Xingye Road, Baoding

邮编 (Post Code): 071000

邮箱 (E-mail): hbqhjckjyxgs@163.com

电话 (Tel): 15830255575





河北秋珩检测科技有限公司
HEBEIQIUHENGJIANCKEKEJIYOUXIANGONGSI

证书编号：QHJC20240823T001


校准环境条件及地点：					
温度	(22.5~22.7) °C	地点	客户门诊一楼中心试验药房		
湿度	(49~52) %RH	其它	大气压101.3kPa		
校准依据：					
JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》					
校准使用的主要计量标准器：					
名称/ 设备编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至	溯源机构
温湿度巡检仪 21-2C02116	(-80~300) °C	温度：(-80~100) °C U=0.05°C, k=2 温度：(150~300) °C U=0.08°C, k=2	24040700118	2025-4-6	北方测盟（北京）科技有限公司
提示说明：					
1、在使用过程中，如对该计量器具的计量性能产生怀疑，请重新校准； 2、未经本实验室书面批准，不得部分复印本证书； 3、本证书未加盖“河北秋珩检测科技有限公司校准专用章”无效； 4、本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效，本证书校准项目已与客户达成约定； 5、根据客户要求和校准文件的规定，建议校准周期间隔为：12 个月； 6、标注“*”参数，不在CNAS认可范围内； 7、本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。					





校准结果

1、布点示意图如下图:

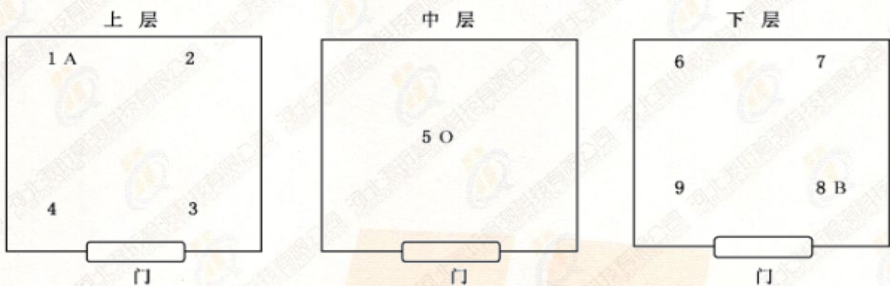

2、温度校准结果:

温度单位: °C

温度设定值	4	技术指标要求	测量结果的不确定度 $U, k=2$
温度上偏差	+0.3	± 2.0	0.4
温度下偏差	-0.4	± 2.0	0.4
温度均匀度	0.4	2.0	/
温度波动度	± 0.2	± 0.5	/

.....以下空白.....